


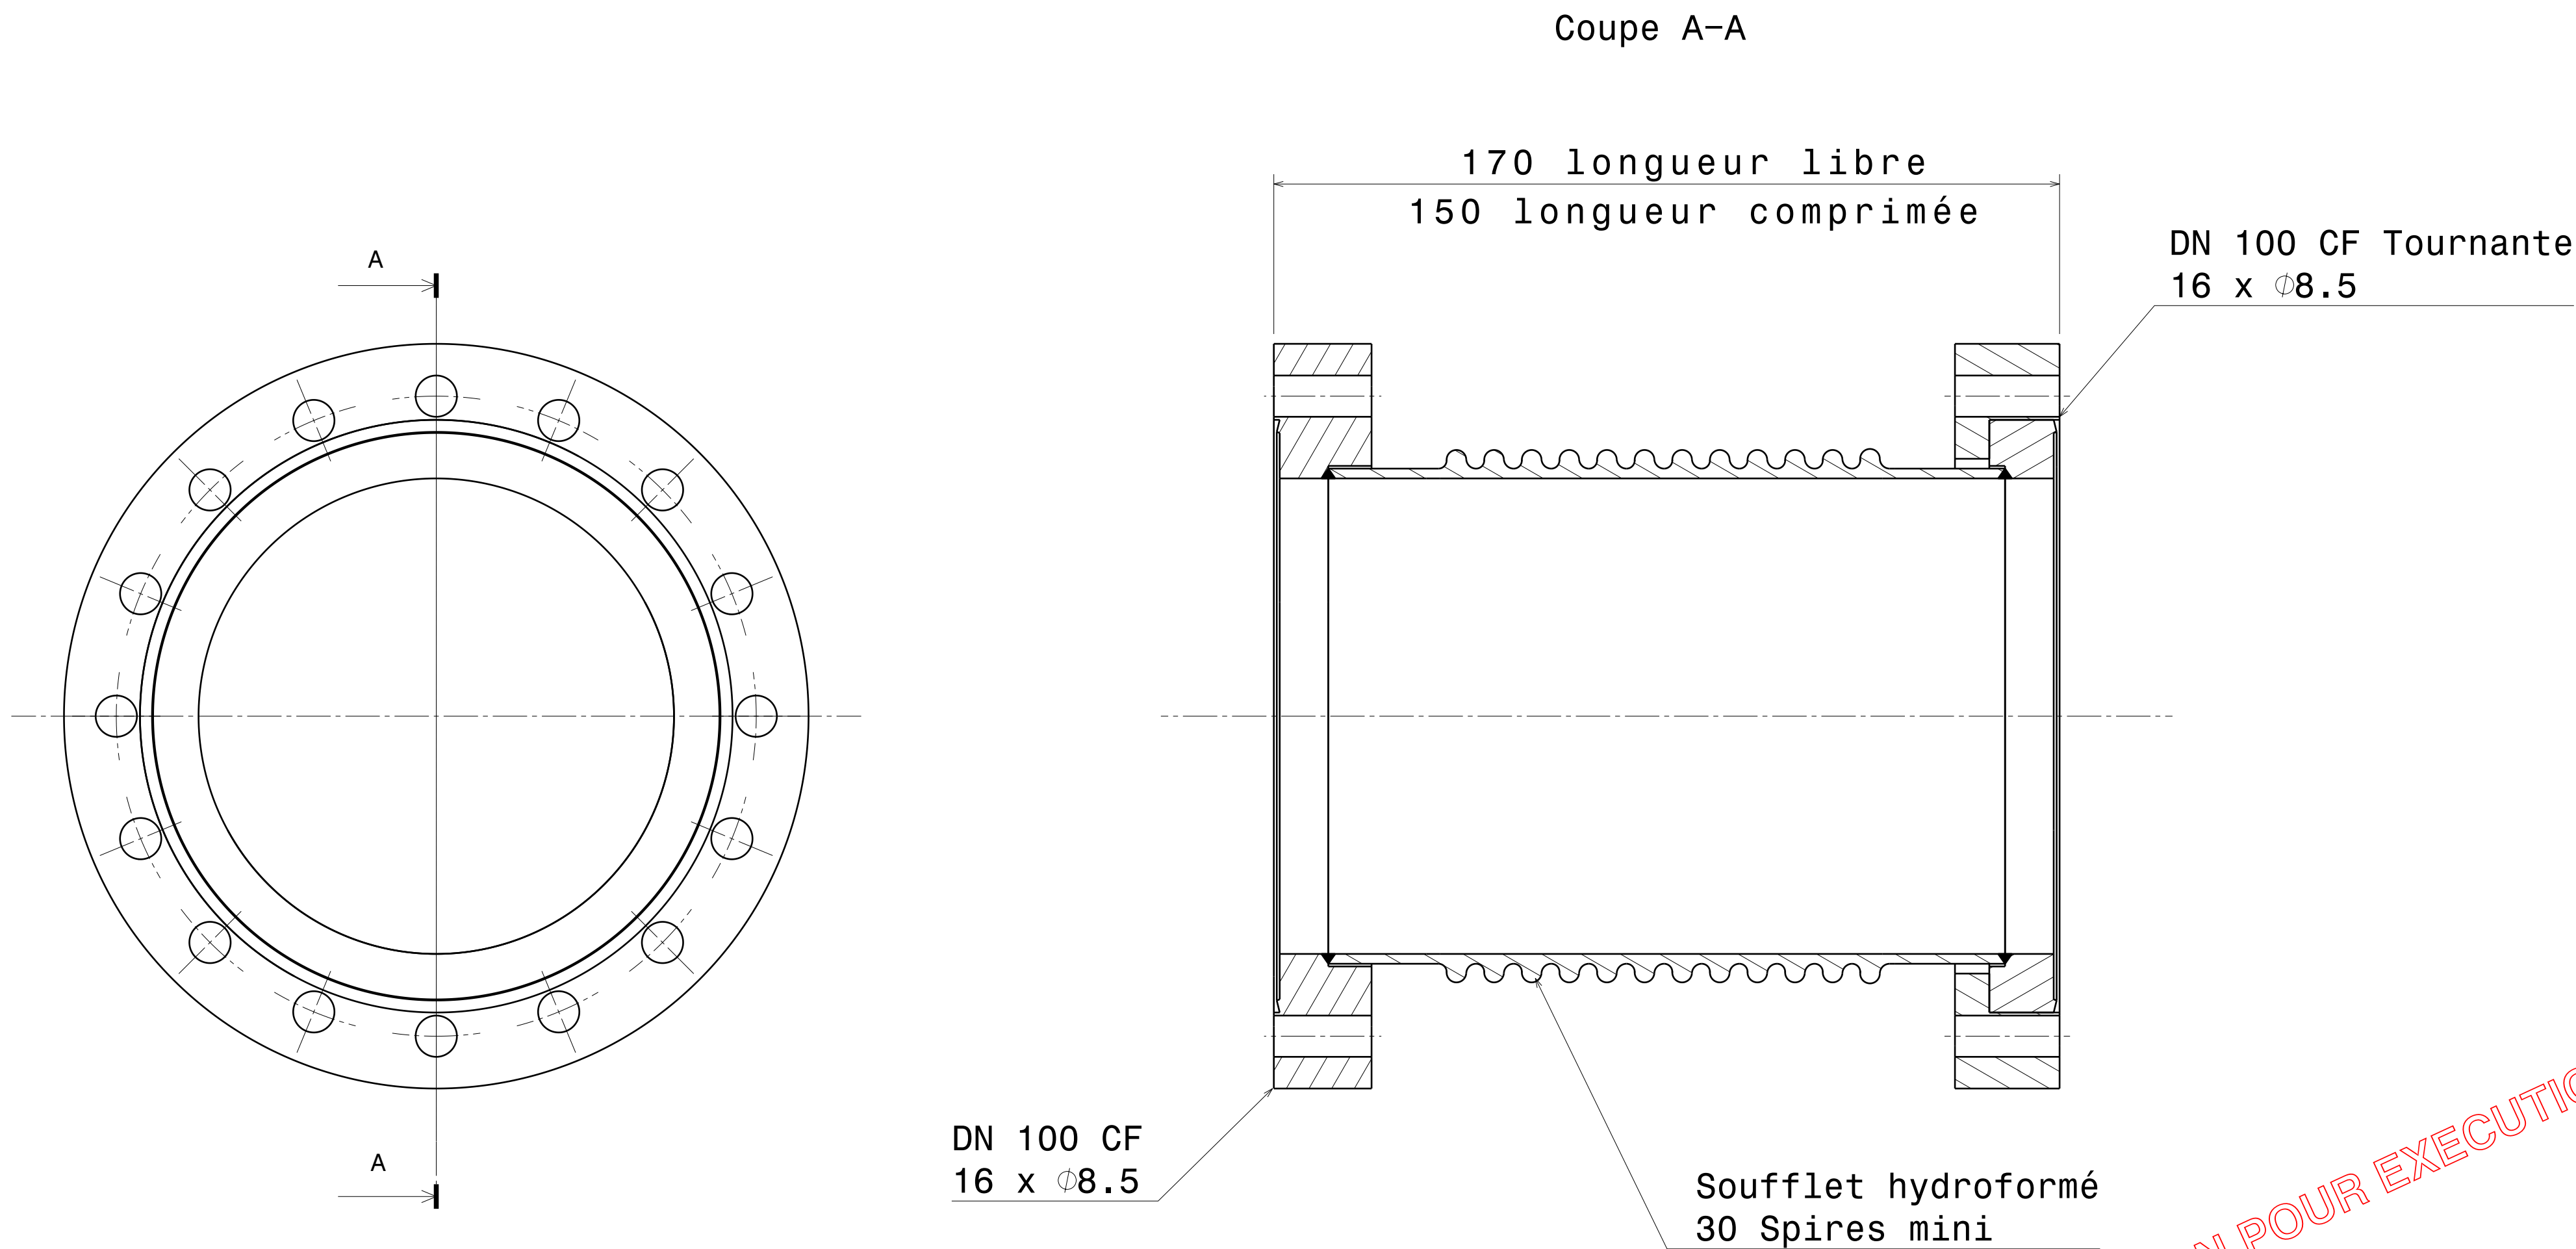

BON POUR EXECUTION

Tolérance General ± 0.5

B	Daudon	23/03/2007	Pour execution
Ind.	Validé par	Date	Commentaires

LPC	LABORATOIRE DE PHYSIQUE CORPUSCULAIRE IN2P3/CNRS - Université Blaise Pascal 63177 Aubière Cedex		Nombre de pièce : 01	
			Tolérances générales	
Projet	TJNAF		Matière	316L
Dossier	Detecteur d'électron		Ech.	1:1
Titre	soufflet(100-150)		Auteur	Verdier
		Origine	LPC Clermont	
		N°	TJN-DetE_D07	
		Format	A2	
		Indice	B	

de	0	>30	>120	>315	>1000
a	30	120	315	1000	mm
Tol.	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5

Ref.	CATDRW-04528
Date	20/03/2007