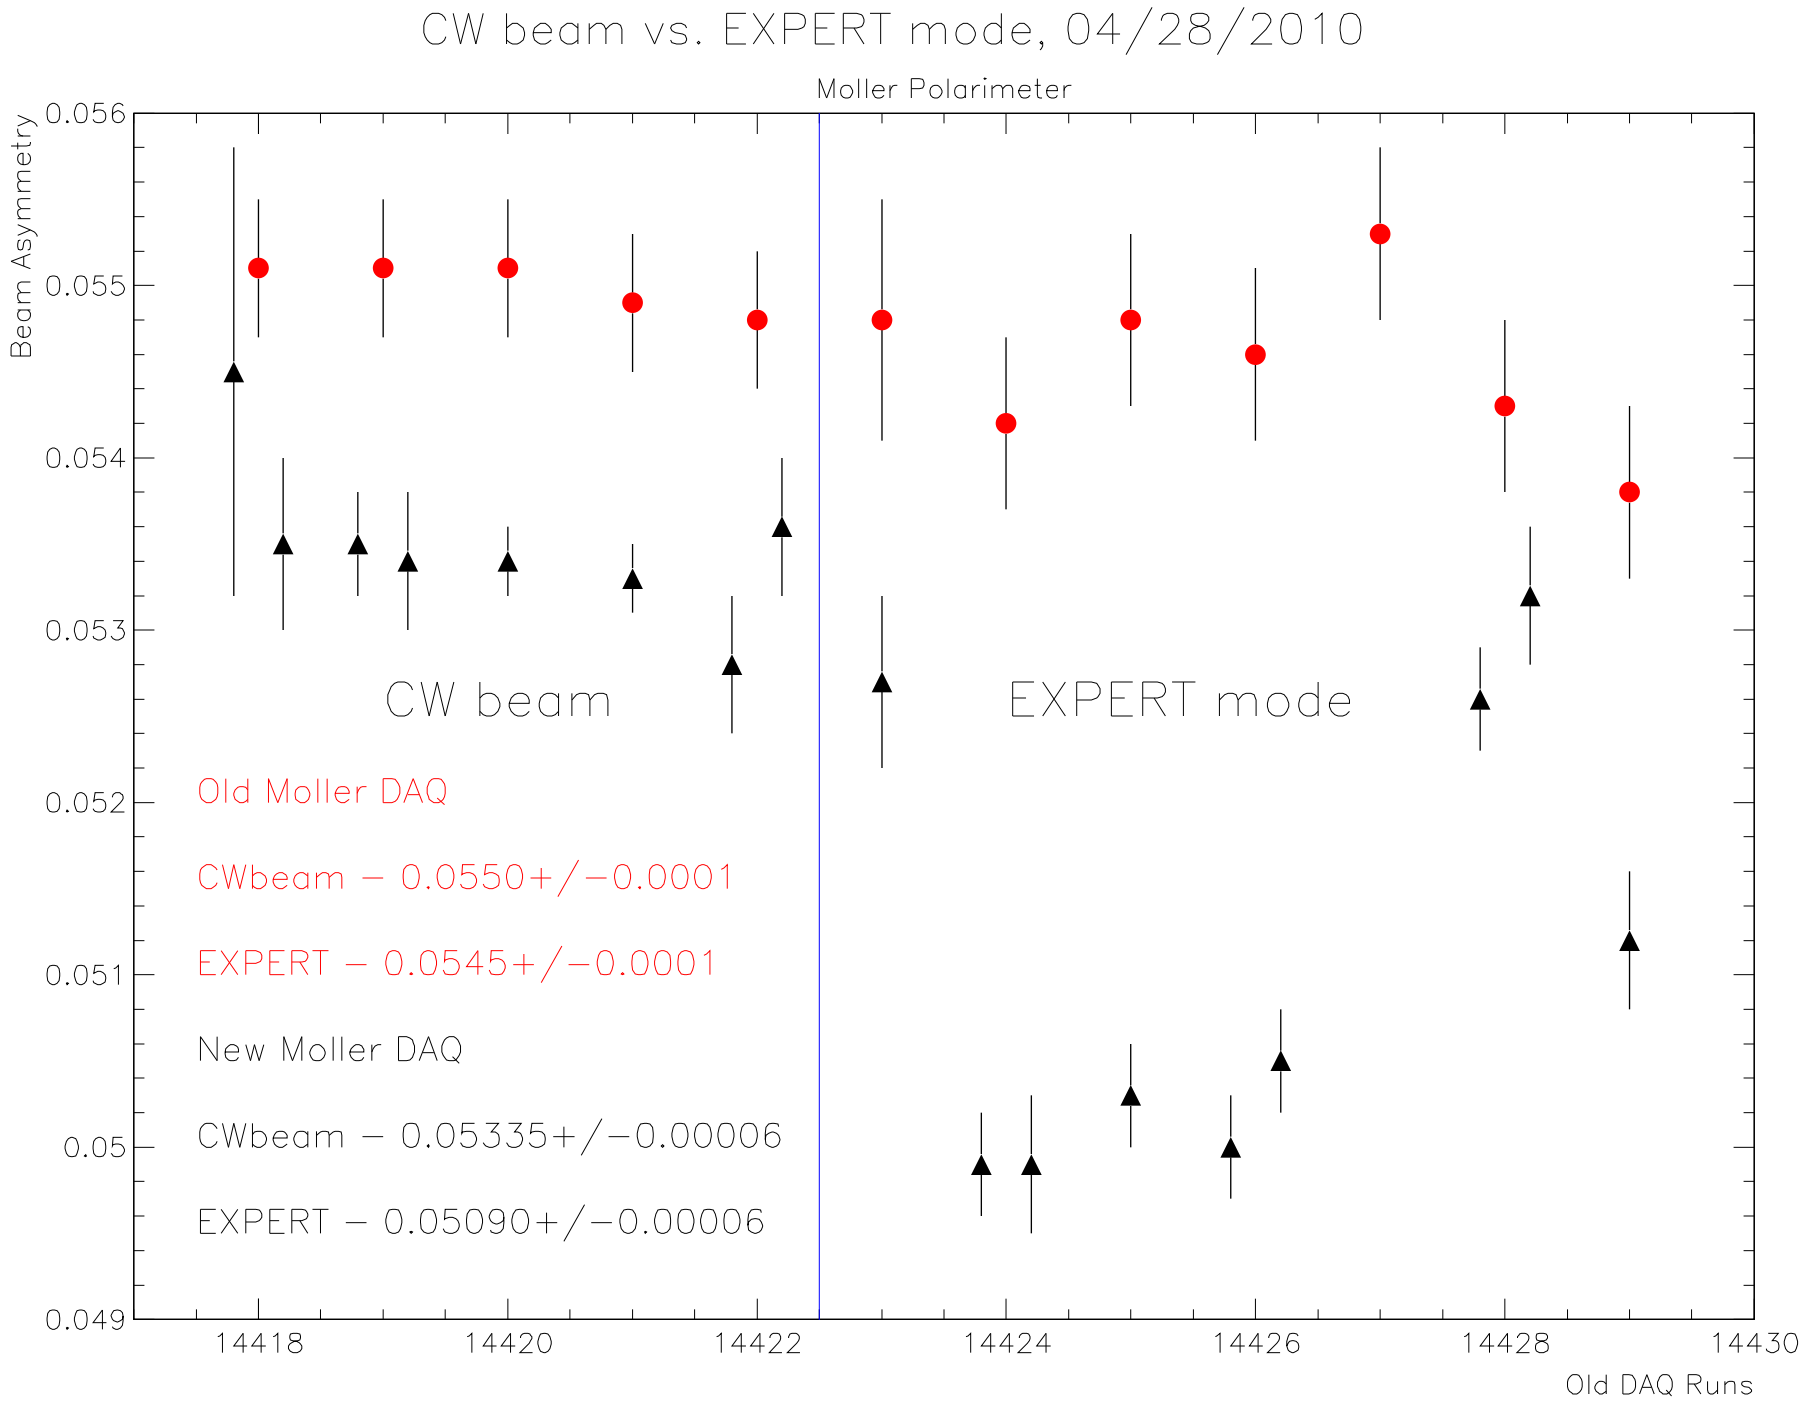
CW beam vs. EXPERT mode, 04/28/2010
Moller Polarimeter
Beam Asymmetry
0.056
0.055
0.054
0.053
0.052
0.051
0.05
0.049
CW beam
EXPERT mode
Old Moller DAQ
CWbeam – 0.0550+/−0.0001
EXPERT – 0.0545+/−0.0001
New Moller DAQ
CWbeam – 0.05335+/−0.00006
EXPERT – 0.05090+/−0.00006
14418
14420
14422
14424
14426
14428
14430
Old DAQ Runs