98/03/23 15.54
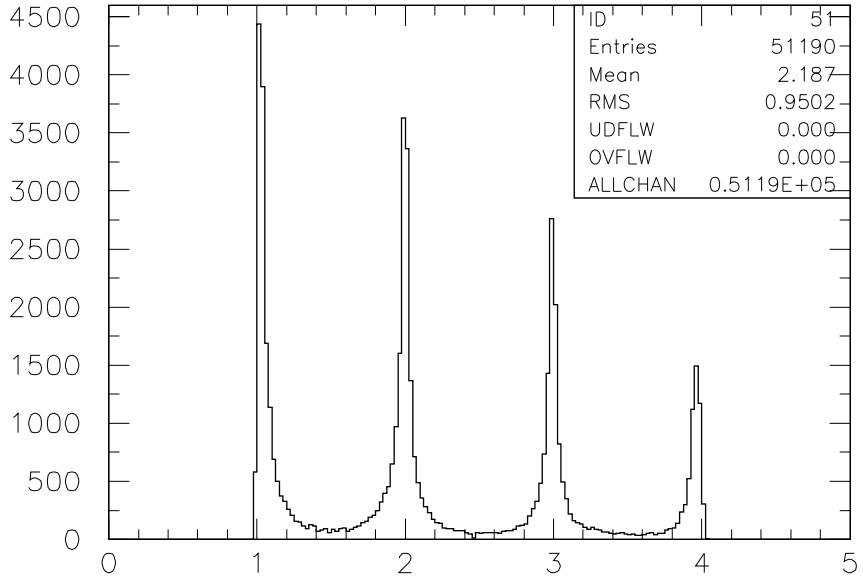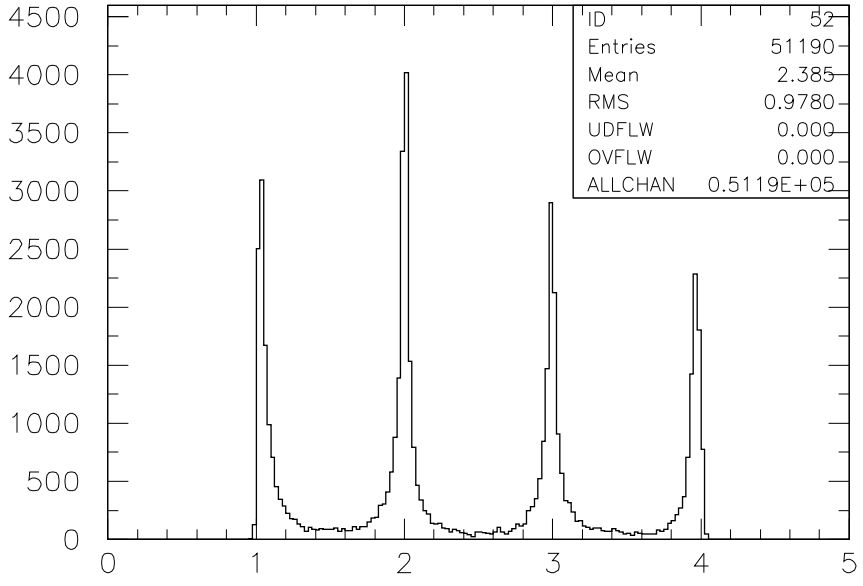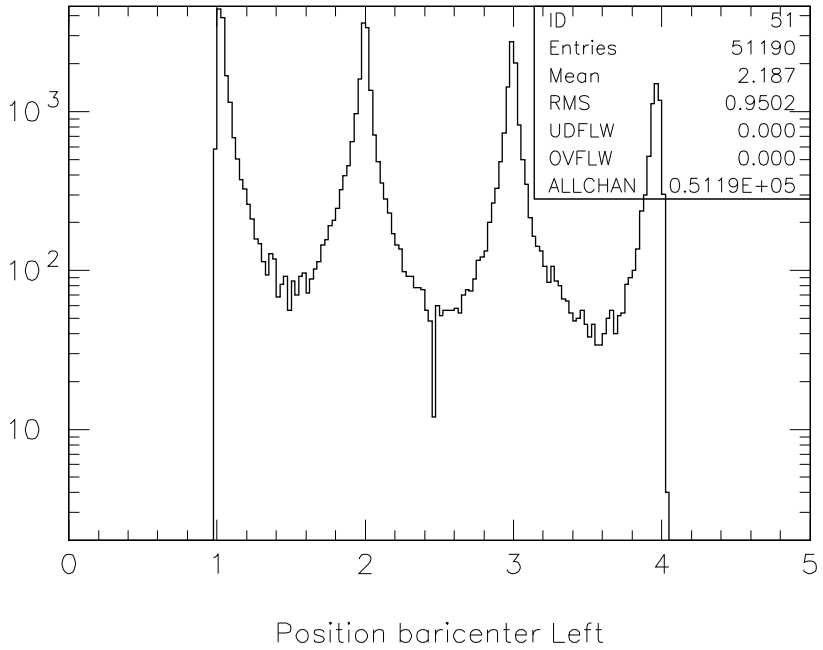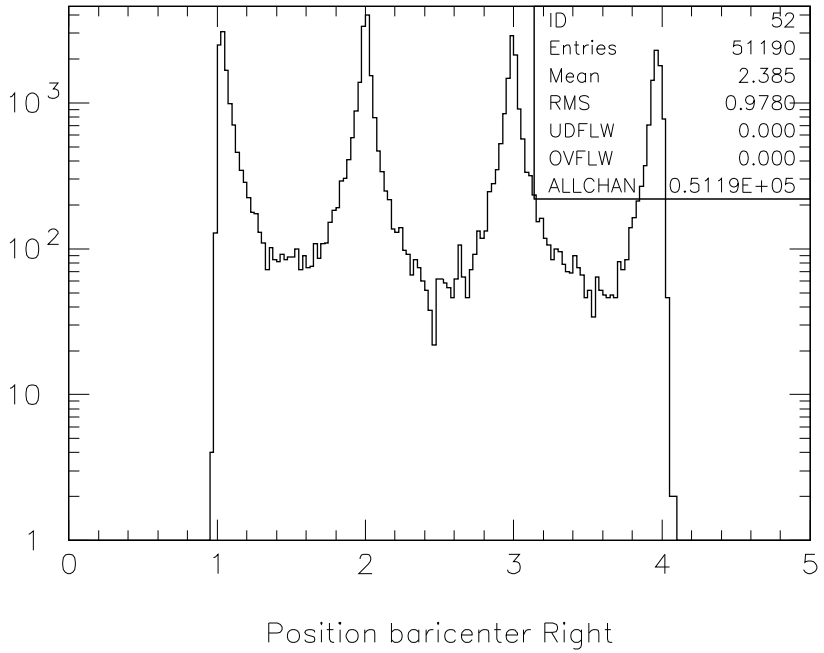
Moller position calibration